

# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0452—2003

## 止 血 钳

Haemostatic forceps

2003-06-20 发布

2004-01-01 实施

国家食品药品监督管理局 发 布

中华人民共和国医药

行业标准

止 血 锥

YY/T 0452—2003

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

2003 年 9 月第一版

\*

书号：155066 · 2-15287

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68522006

## 前　　言

本标准是 GB 2767—1988《普通止血钳》的修订版。

本标准与 GB 2767—1988 相比,主要技术区别如下:

——删去了不作为检验尺寸( $L$ 、 $H$ )的极限偏差。

——按 GB 2766—1995《穿鳃式止血钳通用技术条件》取消夹持拉力。

——取消锁合力数值。

本标准自实施之日起,同时代替 GB 2767—1988《普通止血钳》。

本标准由全国外科器械标准化委员会提出并归口。

本标准主要起草单位:上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂。

本标准主要起草人:章红霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况:

——GB 2767—1964、GB 2767—1973、GB 2767—1981、GB 2767—1988。

# 止 血 钳

## 1 范围

本标准规定了止血钳的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于供夹持人体内血管、组织作止血用的止血钳。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2766—1995 穿鳃式止血钳通用技术条件

YY/T 0173.3—1994 手术器械 钳用鳃轴

YY/T 0173.4—1994 手术器械 脣头钩

YY/T 0173.5—1994 手术器械 脣头齿

YY/T 0173.6—1994 手术器械 锁止牙

YY/T 0173.8—1994 手术器械 蛋形指圈

## 3 分类与命名

3.1 钳子的型式和基本尺寸应符合图1、图2和表1的规定。

3.2 钳子的钳用鳃轴应符合YY/T 0173.3—1994的规定；膂头钩应符合YY/T 0173.4—1994的规定；膂头齿应符合YY/T 0173.5—1994的规定；锁止牙应符合YY/T 0173.6—1994的规定；蛋形指圈应符合YY/T 0173.8—1994的规定。

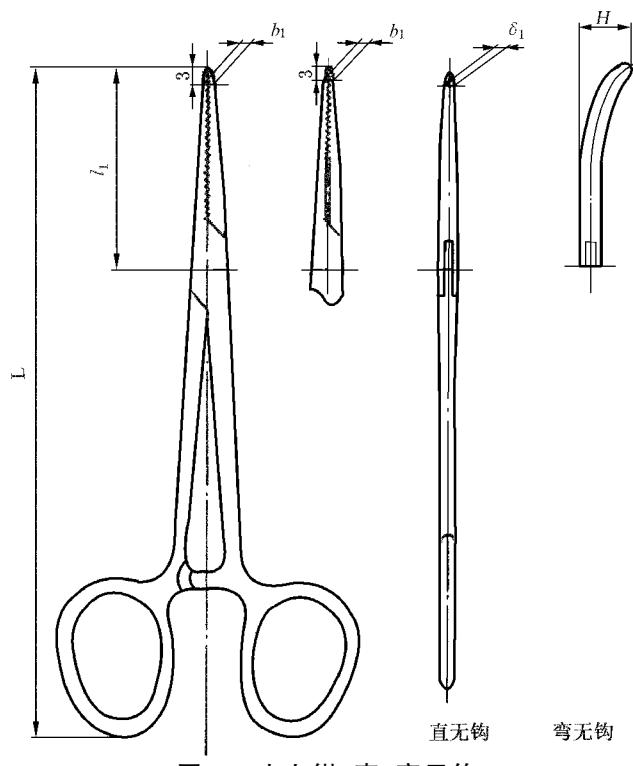


图1 止血钳(直、弯无钩)