



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 20203—2022

药物溶液颜色测定仪

Drug solution colorimeter

2022-04-24 发布

2022-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 型号	1
5 要求	2
6 试验方法	2
7 检验规则	5
8 标志、使用说明书、包装、运输和贮存	6
附录 A（规范性） 标准比色液的制备	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国制药装备行业协会提出。

本文件由全国制药装备标准化技术委员会(SAC/TC 356)归口。

本文件起草单位：天津市天大天发科技有限公司、北京市药品检验所、天津市药品检验研究院、北京量传计量技术服务有限公司。

本文件主要起草人：郭丰、赵海山、刘鹏远、刘海涛、寇晋萍、王卫、郝继博。

药物溶液颜色测定仪

1 范围

本文件规定了药物溶液颜色测定仪的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于具有透射测量功能、通过测量物体的光谱透射特性来定量检测物体颜色三刺激值的药物溶液颜色测定仪(以下简称“测定仪”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。


- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 5698—2001 颜色术语
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 14710—2009 医用电器环境要求及试验方法
- GB/T 26791—2011 玻璃比色皿
- GB/T 36035—2018 制药机械 电气安全通用要求
- JB/T 20188—2017 制药机械产品型号编制方法
- 中华人民共和国药典(2020年版)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 型号

测定仪型号按 JB/T 20188—2017 的规定编制如下:

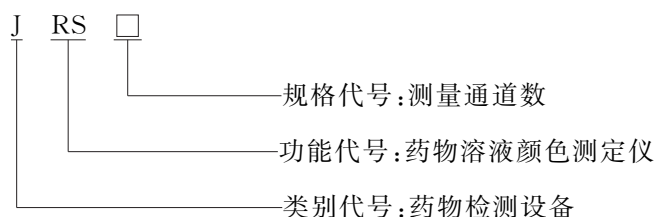

示例: JRS1 型,表示具有一路测量通道的药物溶液颜色测定仪。